по применению полосок индикаторных экспресс-контроля концентрации дезинфицирующего средства **"Офаль"** одноразовых

# "Дезиконт-Офаль" № 154.112.04 ИП

## 1. Назначение

Полоски индикаторные "Дезиконт-Офаль" (далее – индикаторные полоски) экспресс-контроля концентрации дезинфицирующего средства "Офаль", выпускаемые в соответствии с ТУ 9398-039-11764404-2004, предназначены для полуколичественного определения орто-фталевого альдегида в растворах, предназначенных для стерилизации и дезинфекции высокого уровня изделий медицинского назначения.


В комплект поставки входят: индикаторные полоски; элемент сравнения (может быть нанесен на банку); инструкция по применению; контрольные этикетки; банка; упаковочная коробка.

## 2. Применение

В стакан наливают не менее 30 см$^3$ раствора комнатной температуры. Из банки достают индикаторную полоску и погружают её на 1 с в раствор. Полоску извлекают из раствора и быстро удаляют избыток жидкости, проводя ребром полоски по краю стакана, а затем касаясь ребром фильтровальной бумаги. Полоску укладывают индикаторной зоной вверх и выдерживают 1.5 минуты (по секундомеру или часам с секундной стрелкой). Затем быстро в течение 3-5 секунд сопоставляют цвет зоны полоски с цветовой шкалой элемента сравнения.

Полученный результат записывают в прилагаемую этикетку, затем этикетку вклеивают в журнал генеральных уборок или наклеивают на емкость с дезинфицирующим средством.

Схема проведения экспресс-контроля

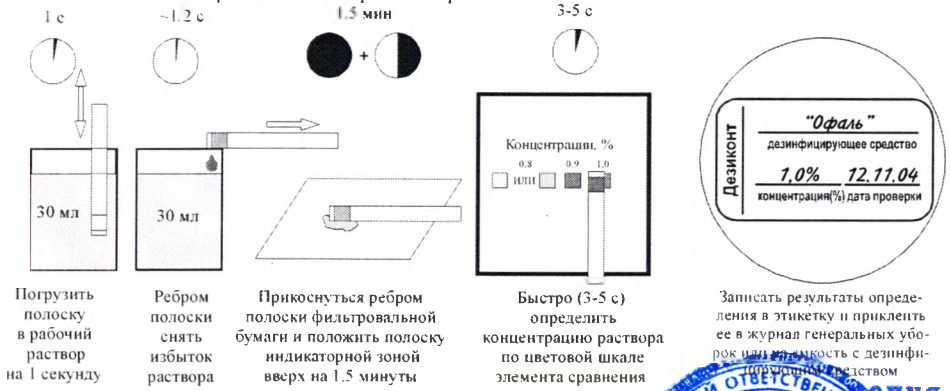


КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР
АНДРЕЕВ В.С.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
«ВИНАР»
«VINAR»
FIRM
Scientific production
МОСКВА

2. Определение концентрации раствора осуществляют в трех повторностях. Результат определения считается достоверным, если он оказался одинаковым не менее чем в двух повторностях.

3. В одной порции раствора можно провести только три определения. При необходимости повторения анализа используют свежую порцию раствора.

4. В случае получения неоднозначных результатов определение концентрации необходимо провести методом рекомендованным производителем данного дезинфицирующего средства.

5. Несоблюдение схемы определения и интервалов времени выдержки индикаторных полосок в растворе и на фильтровальной бумаге может привести к ошибочным результатам.

6. Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете) или искусственном освещении.

***Внимание:***

- не используйте индикаторные полоски "Дезиконт-Офаль" для определения концентрации растворов других дезинфицирующих средств;
- пары аммиака и его растворов (нашатырный спирт) могут оказать влияние на результаты определения, поэтому не применяйте и не храните индикаторные полоски в помещениях, в которых используются аммиак и аммиачные растворы;
- не подвергайте элемент сравнения воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств;
- используйте прилагаемый элемент сравнения ***только*** для данной упаковки индикаторных полосок;
- индикаторные полоски чувствительны к влаге: извлекайте из банки только необходимое для определения количество индикаторных полосок, банку быстро и тщательно закрывайте;
- не удаляйте осушитель из пенала;
- не производите вращательных и помешивающих движений при погружении стакан с раствором;
- не производите после извлечения полоски из дезинфицирующего средст излишков раствора встряхиванием;
- - не кладите полоску индикаторной зоной вниз;
- полоски следует использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия

## 3. Требования безопасности

Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных ве оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Г индикаторными полосками специальных мер безопасности и защиты окружающе требуется.

После использования индикаторные полоски подлежат утилизации, как бытовые

## 4. Хранение и транспортирование

Индикаторные полоски хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от 5°С до 40°С и влажности не более 80%, не подвергая воздействию паров химических веществ.

Срок годности - 1 год с даты изготовления, указанной на упаковке.