ВИНАР
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

ИНСТРУКЦИЯ

по применению полосок индикаторных **"Дезиконт-Фрисепт-Соло"** для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства **"Фрисепт-Соло"** одноразовых

№ 154.222.08 ИП

1. Назначение

Полоски индикаторные "Дезиконт-Фрисепт-Соло", выпускаемые в соответствии с ТУ 9398-80-11764404-2009, предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов дезинфицирующего средства "Фрисепт-Соло" с концентрацией 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; 0,5; 0,6*); 0,7; 1,0; 1,2; 1,5*); 2,0; 2,5; и 3,0*) % по препарату.

В комплект поставки входят (шт): индикаторные полоски-100; инструкция по применению-1; банка-1; элемент сравнения-1 (может быть нанесен на банку); контрольные этикетки-40; упаковочная коробка-1.

Индикаторные полоски предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Рабочие растворы готовят из концентрата в соответствии с «Инструкцией № 1 по применению дезинфицирующего средства «Фрисепт-Соло» (ООО «Септа», Россия)».

2. Применение

2.1 Контроль рабочих растворов концентраций 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1,0% и 2,0% по препарату (зона 1).

В мензурку или стакан наливают 100 мл хорошо перемешанного (избегать вспенивания) рабочего раствора дезинфицирующего средства комнатной температуры. Из банки достают индикаторную полоску и погружают её примерно на 1с в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны. Полоску извлекают из раствора и быстро удаляют избыток жидкости, проводя ребром полоски о край стакана. Полоску кладут на белую фильтровальную бумагу, бумажную или марлевую салфетку индикаторной зоной вверх и выдерживают 1 минуту (по секундомеру или часам с секундной стрелкой). Затем в течение 30 секунд сопоставляют цвет рабочей зоны полоски с цветовой шкалой соответствующего элемента сравнения, не обращая внимания на 2ую зону.

2.2 Контроль рабочих растворов концентраций 0,15%, 0,3%, 0,7%, 1,2% и 2,5% по препарату (зона 2).

В мензурку или стакан наливают 100 мл хорошо перемешанного (избегать вспенивания) рабочего раствора дезинфицирующего средства комнатной температуры. Из банки достают индикаторную полоску и погружают её примерно на 1с в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны. Полоску извлекают из раствора и быстро удаляют избыток жидкости, проводя ребром полоски о край стакана. Полоску кладут на белую фильтровальную бумагу, бумажную или марлевую салфетку индикаторной зоной вверх и выдерживают 1 минуту (по секундомеру или часам с секундной стрелкой). Затем в течение 30 секунд сопоставляют цвет рабочей зоны полоски с цветовой шкалой соответствующего элемента сравнения, не обращая внимания на 1ую зону.

2.3 Контроль рабочих растворов с концентрациями 0,6%; 1.5% и 3,0% по препарату.

Контроль рабочих растворов дезинфицирующего средства «Фрисепт-Соло» концентрации 0,6%; 1,5% и 3,0%, по препарату проводят согласно п. 2.1и п.2.2 после их разведения питьевой водой комнатной температуры согласно таблице разведений (см. Таблицу 1).

Полученный результат записывают в прилагаемую этикетку, затем этикетку вклеивают в журнал генеральных уборок или наклеивают на емкость с дезинфицирующим средством.

Примечания:

1. Необходимо соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе и на фильтровальной бумаге.
2. Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете) или искусственном освещении. Появление на индикаторных полосках ореолов, не изображенных на элементе сравнения, считать несущественным.

**) - определение концентрации проводят после предварительного разведения анализируемой порции рабочего раствора*



3. Раствор, использованный для анализа, нельзя применять для дезинфекции.
4. Определение концентрации раствора проводят три раза. Результат определения считается достоверным, если он оказался одинаковым не менее чем в двух определениях.

При необходимости повторения анализа, используют свежую порцию раствора.


В случае получения неоднозначных результатов определение концентрации необходимо провести методом, рекомендованным производителем данного дезинфицирующего средства.

Таблица 1.

Рекомендуемое разведение анализируемых порций рабочих растворов, концентрации которых не приведены на элементе сравнения.

Концентрация исходного раствора по препарату, %	Разведение, мл		«Дезиконт-Фрисепт-Соло» Концентрации рабочих растворов по препарату, %	
	исходный раствор	вода питьевая	0,3	1,0
0,6	50	50	*	
1,2	25	75	*	
3,0	30	60		*

Схема проведения экспресс-контроля

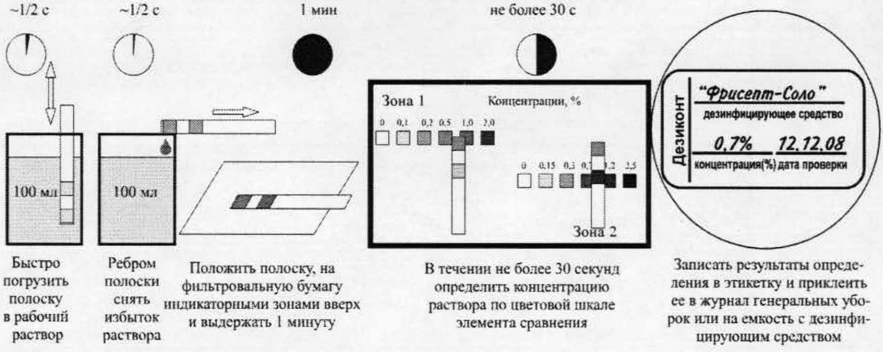

Быстро погрузить полоску в рабочий раствор

Ребром полоски снять избыток раствора

Положить полоску, на фильтровальную бумагу индикаторными зонами вверх и выдержать 1 минуту

В течении не более 30 секунд определить концентрацию раствора по цветовой шкале элемента сравнения

Записать результаты определения в этикетку и приклеить ее в журнал генеральных уборок или на емкость с дезинфицирующим средством

Внимание:

- пары аммиака и его растворов (нашатырный спирт) могут оказать влияние на результаты определения, поэтому не применяйте и не храните индикаторные полоски в помещениях, в которых используются аммиак и аммиачные растворы;
- не используйте индикаторные полоски "Дезиконт-Фрисепт-Соло" для определения концентрации растворов других дезинфицирующих средств;
- не удаляйте избыток раствора с полосок фильтровальной бумагой;
- не подвергайте элемент сравнения воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств;
- используйте прилагаемый элемент сравнения ***только*** для данной упаковки индикаторных полосок;
- извлекайте из пенала только необходимое для определения количество индикаторных полосок, пенал не держите открытым;
- полоски следует использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия банки.

3. Требования безопасности

Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности и защиты окружающей среды не требуется.

После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы.

4. Хранение и транспортирование

Индикатор хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от 5°С до 40°С и влажности не более 80%, не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 15°С.

Срок годности - 1 год с даты изготовления, указанной на упаковке.